

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021



De <ana.fagundes@hospcom.net>
Para <cplsaude@catalao.go.gov.br>
Data 2021-11-28 19:07
Prioridade Mais alta

- 1. HOSPCOM - CONTRATO SOCIAL.pdf (~1010 KB)
- 2.3 HOSPCOM - PROCURAÇÃO JACKELINE - 18.05.22.pdf (~2,3 MB)
- ESCLARECIMENTO.pdf (~742 KB)

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde!

A Hospcom Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ: 05.743.288/0001-08, vem respeitosamente à presença de Vossa senhoria, solicitar ESCLARECIMENTO ao edital de Pregão nº 30/2021 pelas razões de fato e de direito que passa a expor em anexo.

****Por gentileza, confirmar o recebimento do email****

Atenciosamente,

ANA PAULA FAGUNDES
Assistente de Licitação

www.hospcom.net 62 3241.5555

HOSPCOM **17** ANOS

/hospcom

@hospcom

/company/hospcom-hospitalar

HOSPCOM
Porque a vida exige precisão.

CARE Tecnologia que move a vida

Ao Ilustre Sr. Pregoeiro do Setor de Licitações do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO – GO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08, sediada à Rua 104, n.º 74, Setor Sul, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.083-300 (Doc. 02), vem, por intermédio de sua procuradora que esta subscreve (Doc. 01), com fundamentos no Art. 24 do Decreto de n.º 10.024, apresentar seu

ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 30/2021

I. DOS FATOS

Nos termos do que se observa do edital em referência, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, o certame tem Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares, de Informática, Eletrônicos e Mobiliário, para atender as Emenda Parlamentares n.º 03532.661000/1150-01; 03532.661000/1150-03; 03.532.661000/1160-01; 03.532.661000/1160-05; 03.532.661000/1160-10; 03.532.661000/1160-12; 03.532.661000/1160-13; 03.532.661000/1160-14; 03.532.661000/1160-16; 03.532.661000/1160-18; 03.532.661000/1160-19; 03.532.661000/1160-20; 03.532.661000/1160-22; 03.532.661000/1160-23; 03.532.661000/1160-24; 03.532.661000/1160-25; 03.532.661000/1180-06, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Senhores, ao analisarmos a descrição do item 45 (DEA), notamos a necessidade de fazermos um esclarecimento, visando assegurar a participação e a isonomia entre as propostas.

Abaixo elencamos o ponto no qual entendemos que seja passível de esclarecimento:

O termo de referencia esta incompleto, deixando de elencar itens de extrema importância para o conjunto e a usabilidade do equipamento, permitindo que empresas ofertem um produto incompleto sem a presença de partes fundamentais para o uso.

Logo, sugerimos que se inclua essas especificações “Caso o choque não seja indicado, o equipamento deve auxiliar, por comando de voz, o usuário a aplicar manobras de RCP” pois a orientação verbal é mais um ponto que auxilia na resolução na intercorrência, “O equipamento deve permitir a operação em vítimas adultas e crianças”, este item faz com que o equipamento atenda todos os possíveis pacientes. “deve efetuar a carga de forma automática, ajustando a forma de onda de choque de forma a respeitar as características individuais dos pacientes, sendo o choque requerido para adulto, no mínimo de 200 joules e para crianças, no mínimo de 50 joules.” A importância de limitar qual a potencia mínima de choque a ser descarregado nos pacientes no ato da intercorrência, faz com que o equipamento seja mais funcional e eficaz, “O equipamento possui uma bateria descartável com capacidade de no mínimo 270 descargas de 200J (mínimo); 170 descargas de 360J (mínimo) e validade: até 5 anos.” temos que enfatizar os limites de autonomia de bateria, para o melhor funcionamento e para o equipamento estar sempre pronto para uso. “Armazenamento de ondas: até 5 horas de curva de ECG” como estamos falando sobre um equipamento de suporte a vida, devemos nos resguardar com um histórico da intercorrência para nossa segurança ou para análise futura junto de um profissional especialista.

“ Deve realizar auto teste de funcionamento diário” , “Deve ser construído em material altamente resistente a vibrações, calor, vedação a umidade, poeira, secreções, água; resistência a queda de altura mínima de 01 (um) metro. Deverá possuir proteção contra a entrada de líquidos .”

Nelas estão presentes dados que traz uma segurança ao paciente e melhor avaliação do quadro do mesmo, assim nivelando a ampla concorrência e um equipamento de melhor condição. Por se tratar de um desfibrilador externo, temos que saber todas parâmetros necessários para suprir a demanda e podermos aproveitar este recurso.

Ressaltamos que estas sugestões trazem ao órgão maior credibilidade e possibilidade de adesão de produtos de alta qualidade e segurança para melhor atender as demandas do estabelecimento.

II. DA ADEQUAÇÃO


A HOSPCOM apresenta sugestão de adequação das especificações técnicas, visando melhorias na aquisição de produtos de melhor qualidade por parte do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO – GO**, nessas sugestões estão presentes dados que trazem maior segurança ao paciente e melhorias na avaliação do quadro do mesmo através de equipamentos com qualidade superior às solicitadas no termo de referência atual, porém equiparadas quanto ao custo/benefício dos recursos disponíveis para a aquisição nesta contratação, assim nivelando a ampla concorrência e equipamentos de melhores condições de operação.

III. DO PEDIDO

Ante o exposto, REQUER seja recebido o presente pedido de Esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 0030/2021 para adequações técnicas no termo de referência conforme esclarecimentos referentes as especificações dos itens solicitados para a aquisição de equipamentos com as tecnologias necessárias no atendimento eficiente para os fins solicitados e também para que se eleve o nível dos produtos que pleitearão a concorrência.

*Termos em que
Pede e espera deferimento.*

Goiânia, 26 de novembro de 2021.

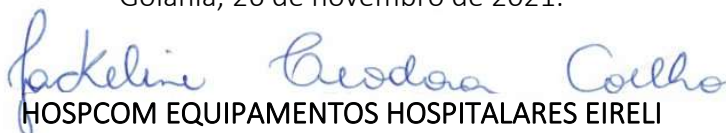

JACKELINE TEODORA COELHO

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08

p.p Jackeline Teodora Coelho RG: 685.950 SSP/TO CPF: 015.305.151-57