

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Departamento de Patrimônio e Manutenção**

Catalão, 21 de janeiro de 2026.

Em respostas ao pregão eletrônico n. 90092/2025 – menor preço por item – processo n. 2025031082.

ITEM 001 – EMPRESA BH DENTAL. Não atende – motivo : Não descreve a quantidade mínima de ciclos de autoclavagem e do rolamento de cerâmica, o modelo ofertado não possui dois dutos, um para alimentação de ar da turbina e outra da alimentação de água do spray, a mesma apresenta 04 dutos aos quais não encaixa nos nossos terminais de equipo, bordem de dois furos. Não foi informado a rotação de turbina em RPM.

ITEM 009 – Auto clave 21 I – Não atende - Verificando o manual foi constatado que o equipamento não possui sistema de ajuste de altitude, tampa da câmara de esterilização em aço inox, válvula de segurança ante vácuo, não informa que porta possui travamento em 04 pontos, não possui sistema de rastreabilidade, não informa que a secagem com a porta entre aberta, não informou o consumo de watts / hora.

ITEM 13 – Atende plenamente

ITEM 16 – Atende plenamente

ITEM 17 – Atende plenamente

ITEM 18 – Atende plenamente

ITEM 20 – Atende plenamente

ITEM 22 – Atende plenamente

ITEM 29 – Atende plenamente

ITEM 31 – Atende plenamente


ITEM 49 – Atende plenamente

ITEM 50 – Atende plenamente

Thiago José Maria Rodrigues - ME

Contrato nº. 001/2023

CPF – 962.853.461-00

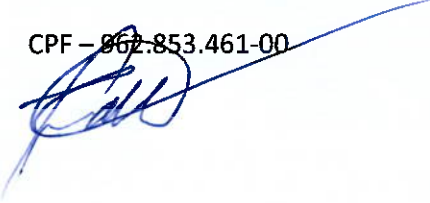

Márcia Elias Rosa  
Coordenadora Depto.  
Patrimônio e Manutenção  
Portaria nº 108539

